kuraray

Noritake

PANAVIA™ V5

SIM, TODAS.

TODAS AS INDICAÇÕES DE CIMENTAÇÃO
EXCELENTE RESISTÊNCIA DE UNIÃO
ALTAMENTE ESTÉTICO E SIMPLES

Kuraray Noritake Dental Inc.

www.kuraraynoritake.com

SIMPLES, FÁCIL DE USAR

3 passos simples para cimentar todas suas restaurações:

1. Aplicar primer na peça

CLEARFIL™
CERAMIC PRIMER PLUS

Para Virtualmente Todas as Próteses

2. Aplicar primer no dente

PANAVIA™ V5
TOOTH PRIMER

Para Estrutura Dental, Resinas Compostas ou Metais intraorais

3. Aplique fácilmente a pasta misturada na peça

PANAVIA™ V5 PASTE

Polimerização Dual. Melhor Manipulação

UM CIMENTO, TODAS AS INDICAÇÕES

Um único cimento atende todas as suas necessidades

Coroas

Pontes

Facetas

Inlays / Onlays

Pontes adesivas

Próteses sobre Implantes

Pinos / núcleos

EXCELENTE RESISTÊNCIA DE UNIÃO

O PANAVIA™ V5 inclui o monômero MDP original, que tem uma resistência de união excepcional comprovada em pesquisas realizadas ao longo de 15 anos.

Com uma excelente resistência de união, semelhante ao Padrão de Ouro de dos adesivos, o CLEARFIL™ SE BOND, ele proporciona **resultados previsíveis** para virtualmente todas as restaurações.

Resistência ao Cisalhamento

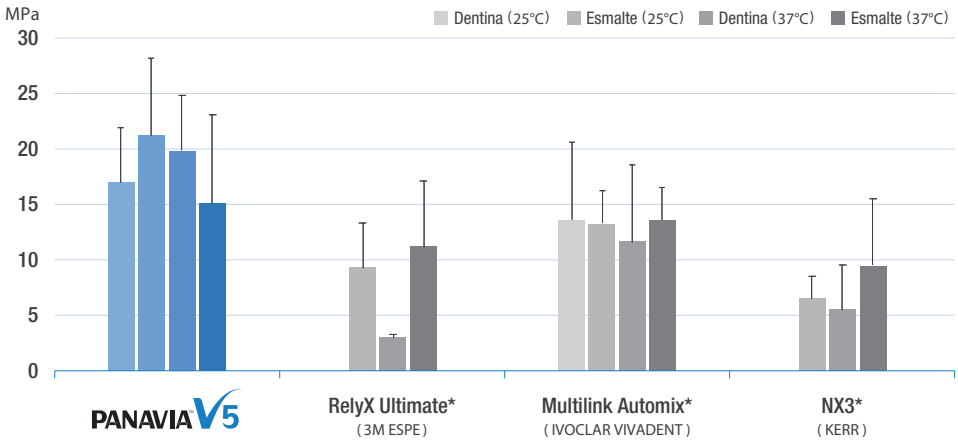

Prof. Dr. J. Burgess et al. 2015 IADR/AADR/CADR General Session
Bond of Resin Cements to Tooth Substrates in Self-cure Mode
*Não é uma marca comercial da Kuraray Noritake Dental Inc.

EXCELENTE ESTÉTICA

Uma ampla variedade de cores adequadas para qualquer situação clínica

Cores

Universal	Clear	Brown	White	Opaque
(A2)	(Claro)	(Marrom (A4))	(Branco)	(Opaco)

Somente autopolimerização

Estabilidade da cor em água a 37°C

(Alteração da cor da linha de cimentação, modo de autopolimerização)

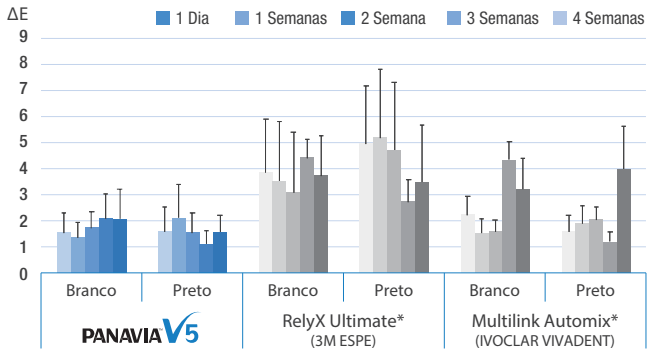

Prof. Dr. John Burgess et al. 2015 IADR/AADR/CADR General Session
Color Stability of Amine-free Dental Cement
*Não é uma marca comercial da Kuraray Noritake Dental Inc.

O PANAVIA V5™ não mostrou nenhuma mudança de cor independentemente do período.

Fluorescência Natural

A Fluorescência Natural com a aparência semelhante a um dente natural completa as características de excelente estética.

EXCELENTE ADESÃO À ZIRCÔNIA

"...independentemente dos métodos de condicionamento, os cimentos a base de MDP apresentaram valores de adesão mais favoráveis em comparação com outros tipos de cimentos resinosos em testes de micro e macro-tração"

Systematic Review of Adhesion Studies on Zirconia
M. Özcan, J Dent Res Vol #90 A: 374, 2011
www.iadr.org

PROCEDIMENTO BÁSICO PARA RESTAURAÇÕES

Limpar e Secar

Limpar e secar a superfície do dente e, em seguida, testar a adaptação da restauração

Jatear

Se necessário, jatear com óxido de alumínio (30-50 µm, 0,1-0,4 MPa / 15-58 PSI / 1-4 kgf/cm^2) e, em seguida, limpar em ultrassom e secar

Aplicar o CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS*

Aplicar o CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS e evaporar o solvente

Aplicar o TOOTH PRIMER

Aplicar o TOOTH PRIMER, deixar agir durante 20 segundos e aplicar um jato de ar suave

Aplicar o cimento

Aplicar a pasta PANAVIA™ V5, remova o excesso de cimento e, em seguida, fotoativar durante 10 segundos
O método de exposição curta à luz também é possível: Fotoativar durante 3-5 segundos e remover o excesso com uma sonda exploradora.
Deixe durante 3 minutos'

* Para Disilicato de Lítio, Pinos de Fibra de Vidro, Facetas ou Pontes Adesivas, o condicionamento ácido é necessário.

PANAVIA™ V5 Professional Kit

#3980-WD

Conteúdo: 1 Seringa de 2,4 mL (Universal (A2)), 1 Seringa de 2,4 mL (Claro), 1 Seringa de 2,4 mL (Marrom (A4)), 1 Seringa de 2,4 mL (Branco), 1 Seringa de 2,4 mL (Opaco), 1 Pasta de Prova de 1,8 mL (Universal (A2)), 1 Pasta de Prova de 1,8 mL (Claro), 1 Pasta de Prova de 1,8 mL (Marrom (A4)), 1 Pasta de Prova de 1,8 mL (Branco), 1 Pasta de Prova de 1,8 mL (Opaco), 1 Primer Dental de 2 mL, 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS de 2 mL, 1 Seringa K-ETCHANT de 3 mL, 30 Pontas de mistura, 10 Pontas Endo, 50 Pincéis aplicadores (fino <prata>), 1 Placa de mistura, 20 Pontas de agulha

PANAVIA™ V5 Standard Kit

#3981-WD Universal (A2)
#3982-WD Clear

Conteúdo: 1 Seringa de 4,6 mL, 1 Primer Dental de 2 mL, 1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS de 2 mL, 1 Seringa K-ETCHANT de 3 mL, 15 Pontas de mistura, 5 Pontas Endo, 50 Pincéis aplicadores (fino <prata>), 1 Placa de mistura, 20 Pontas de agulha

PANAVIA™ V5 Introductory Kit

#3983-WD Universal (A2)
#3984-WD Clear

Conteúdo: 1 Seringa de 2,4 mL,
1 Primer Dental de 2 mL,
1 CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS de 2 mL,
10 Pontas de mistura,
50 Pincéis aplicadores (fino <prata>), 1 Placa de mistura

PANAVIA™ V5 COLOR KIT Clear e Universal A2

#3641-WD

Conteúdo: 1 Seringa de 2,4 mL (Universal (A2)),
1 Seringa de 2,4 ml (Claro),
1 Pasta de Prova de 1,8 mL (Universal (A2)),
1 Pasta de Prova de 1,8 mL (Claro),
1 Primer Dental de 2 mL, 15 Pontas de mistura, 1 Placa de mistura

PANAVIA™ V5 Paste

#3611-WD Universal (A2)
#3612-WD Clear
#3613-WD Brown (A4)
#3614-WD White
#3615-WD Opaque

Conteúdo: 1 Seringa de 4,6 mL, 20 Pontas de mistura

PANAVIA™ V5 Try-in Paste

#3621-WD Universal (A2)
#3622-WD Clear
#3623-WD Brown (A4)
#3624-WD White
#3625-WD Opaque

Cada 1 Pasta de Prova de 1,8 mL

PANAVIA™ V5 Tooth Primer

#3635-WD

1 frasco (4 mL)

CLEARFIL™ CERAMIC PRIMER PLUS

#3637-WD

1 frasco (4 mL)

K-ETCHANT Syringe

#3252-WD

Conteúdo: 2 Seringas K-ETCHANT (3 mL), 40 pontas de agulha

#3626-WD Ponta de mistura (20)
#3629-WD Ponta Endo (S) (20)

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan
Website **www.kuraraynoritake.com**

- Antes de utilizar este produto, certifique-se de ler as Instruções de Uso fornecidas com o produto.
- As especificações e a aparência do produto estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.
- A cor impressa pode diferir ligeiramente da cor real.

"PANAVIA" e "CLEARFIL" são marcas comerciais da KURARAY CO., LTD
"KATANA" é uma marca comercial da NORITAKE CO., LTD

Importado no Brazil por:
KURARAY SOUTH AMERICA LTDA.
Av. Paulista Nº 1636, sala 405, Bela Vista, CEP: 01310-200-São Paulo/SP
CNPJ 12.333.284/0001-17
Responsável Técnico: Luiz Augusto Vieira - CRF/SP 30996
Registro ANVISA Nº: 81777910004 / 81777910003 / 81777910012/ 81777910016/ 81777910015/ 81777910014

IM34-01 12/2019